

お詫びと訂正

眼科ケア 23 巻 10 号の 30 ページにおきまして、誤りがございました。
ご執筆の先生ならびに読者の皆様に、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

P.30 特集 4 「9 方向眼位検査」

図 3 「右上方視での screen comitance test と半透明オクルーダーによるひき運動検査」

【誤】

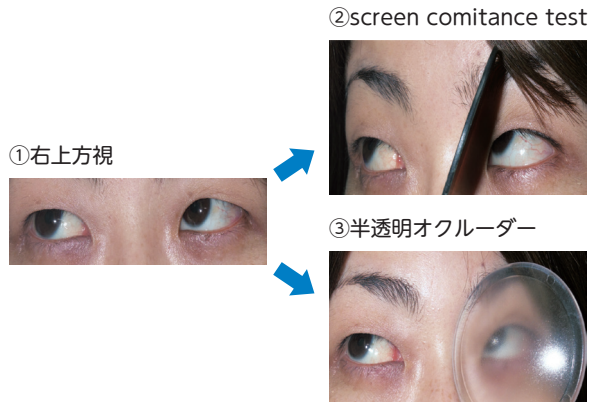


図 3 右上方視での screen comitance test と半透明オクルーダーによるひき運動検査
ひき運動にて右眼下斜筋が可動していることがわかる。

【正】

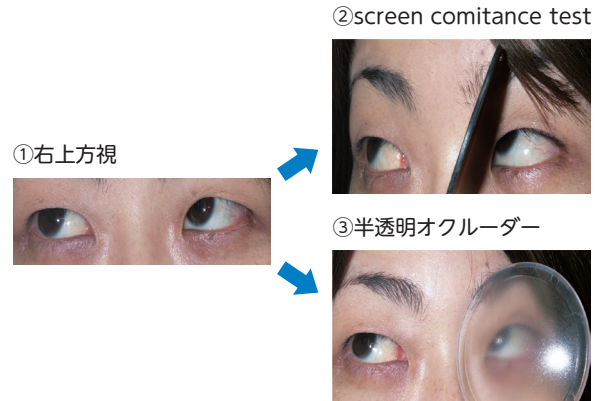


図 3 右上方視での screen comitance test と半透明オクルーダーによるひき運動検査
ひき運動にて左眼下斜筋が過動していることがわかる。