

お詫びと訂正


オペナーシング 2025 年秋季増刊におきまして、下記の誤りがございました。
著者および読者の皆さまに謹んでお詫び申し上げますとともに、以下に訂正いたします。

該当箇所


・4 章 手術室の人工呼吸器関連機器

p. 148 高流量鼻カニューレ (HFNC) 図 1、図 2

【誤】

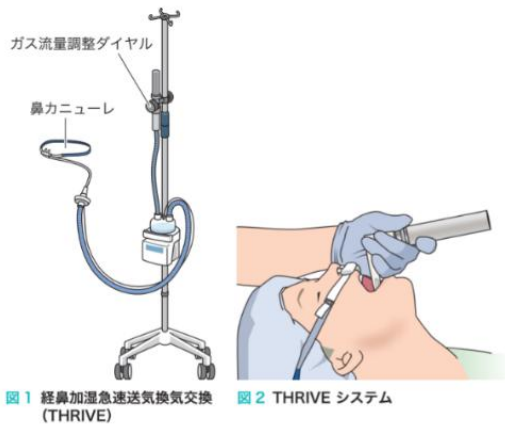

【正】

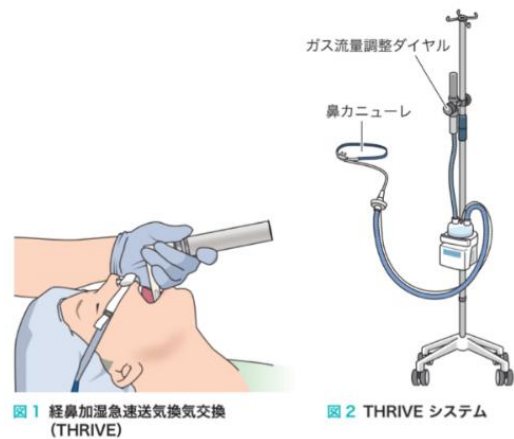

・7章 手術室の診断・治療関連機器

p. 232～237 内視鏡システム

図2 図のタイトル

【誤】

内視鏡外科手術（画像提供：オリンパス株式会社、おなかの健康ドットコム）

【正】

内視鏡外科手術（画像提供：オリンパスマーケティング株式会社）

図4 図のタイトル

【誤】

内視鏡の分類（画像提供：オリンパス株式会社、おなかの健康ドットコム）

【正】

内視鏡の分類（画像提供：オリンパスマーケティング株式会社）

図7 図のタイトル・内容

【誤】

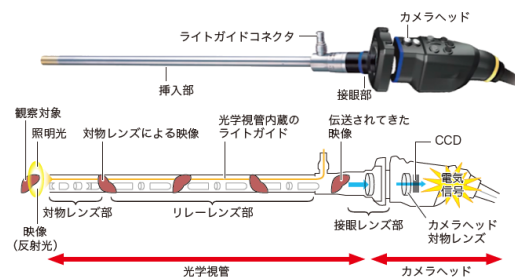


図7 光源装置の照明が届くまで（画像提供：オリンパス株式会社、おなかの健康ドットコム）

【正】

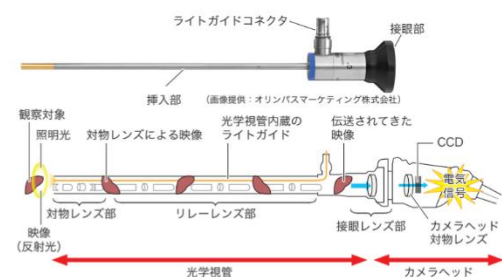


図7 光源装置の照明が届くまで

図8 図のタイトル・内容

【誤】

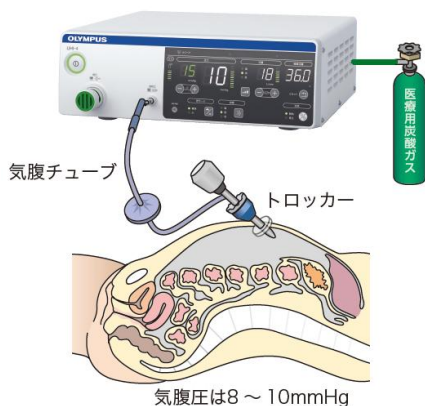


図8 気腹装置の接続（画像提供：オリンパス株式会社、おなかの健康ドットコム）

【正】

（画像提供：オリンパスマーケティング株式会社）



図8 気腹装置の接続